

エラーチェック手順

申請データ作成(E04: (医療機器)製造販売届書)

届出の別 | 製造販売業の許可の種類 | 製造販売業の許可番号及び年月日 | 類別名称 | 使用目的、効能又は効果 | 形状、構造及び原理 | 原材料又は構成部品 | 品目仕様 |

原材料又は構成部品 編集 編集状況

001: 【原材料又は構成部品】

完了がわで
シフトがチェック
変して終了

チェック

編集前に戻す

構成

構成名称

001: 【構成】

原材料

001: 【原材料】

原材料名

原案等登録番号

原材料規格

分量

血液・体液等の接触の有無

承認前例

001: 【承認前例】

承認番号

販売名・会社名

ウシ等由来原材料

原材料

TSE番号

001: 【ウシ等由来原材料】

ウシ等の動物名

使用部位

001: 【使用部位】

部位コード

使用部位入力

部位名称

原産国コード

原産国名

国名検索

組成

組成名称

組成成分

001: 【組成成分】

組成成分規格

分量

承認前例

001: 【承認前例】

承認番号

販売名・会社名

通常モード

一括チェック

完了

キャンセル

1. 画面右上の「チェック」ボタンを押します。

データ検証結果


?

入力データの一部に誤りがあるか、中断箇所があります。検証結果の詳細一覧を表示しますか？


はい(Y)

いいえ(N)

2. 不備がある旨のMSG に対し「はい(Y)」を応答します。

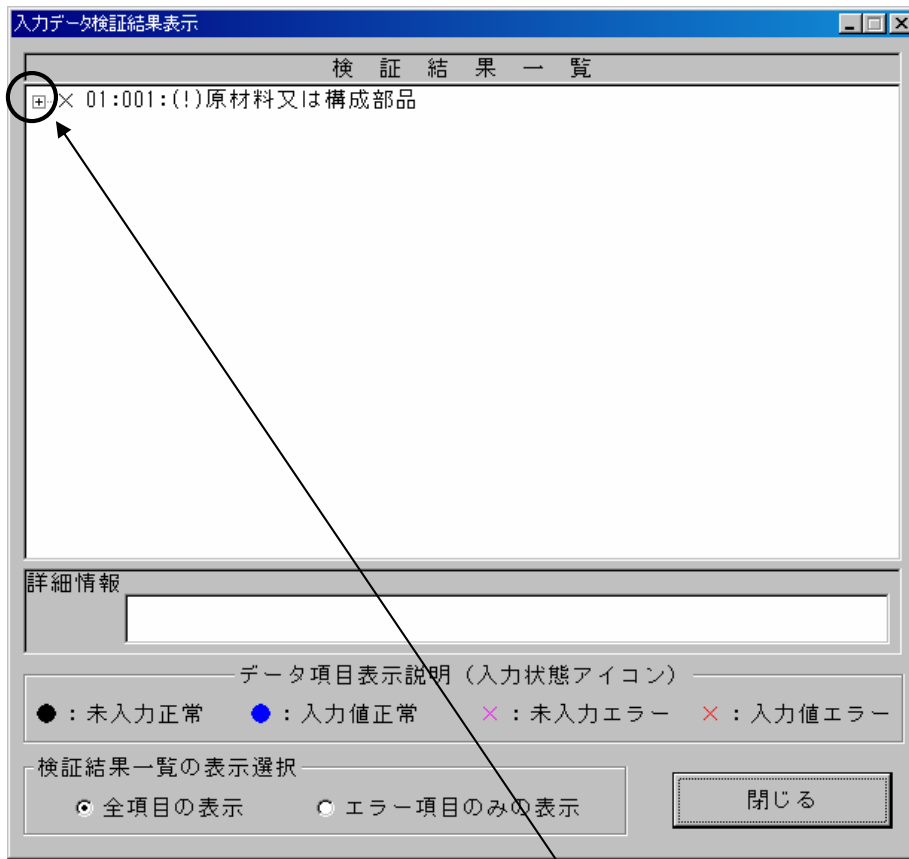

3 . 検索結果が表示されますので、大項目の「+」を押して詳細エラーを確認します。

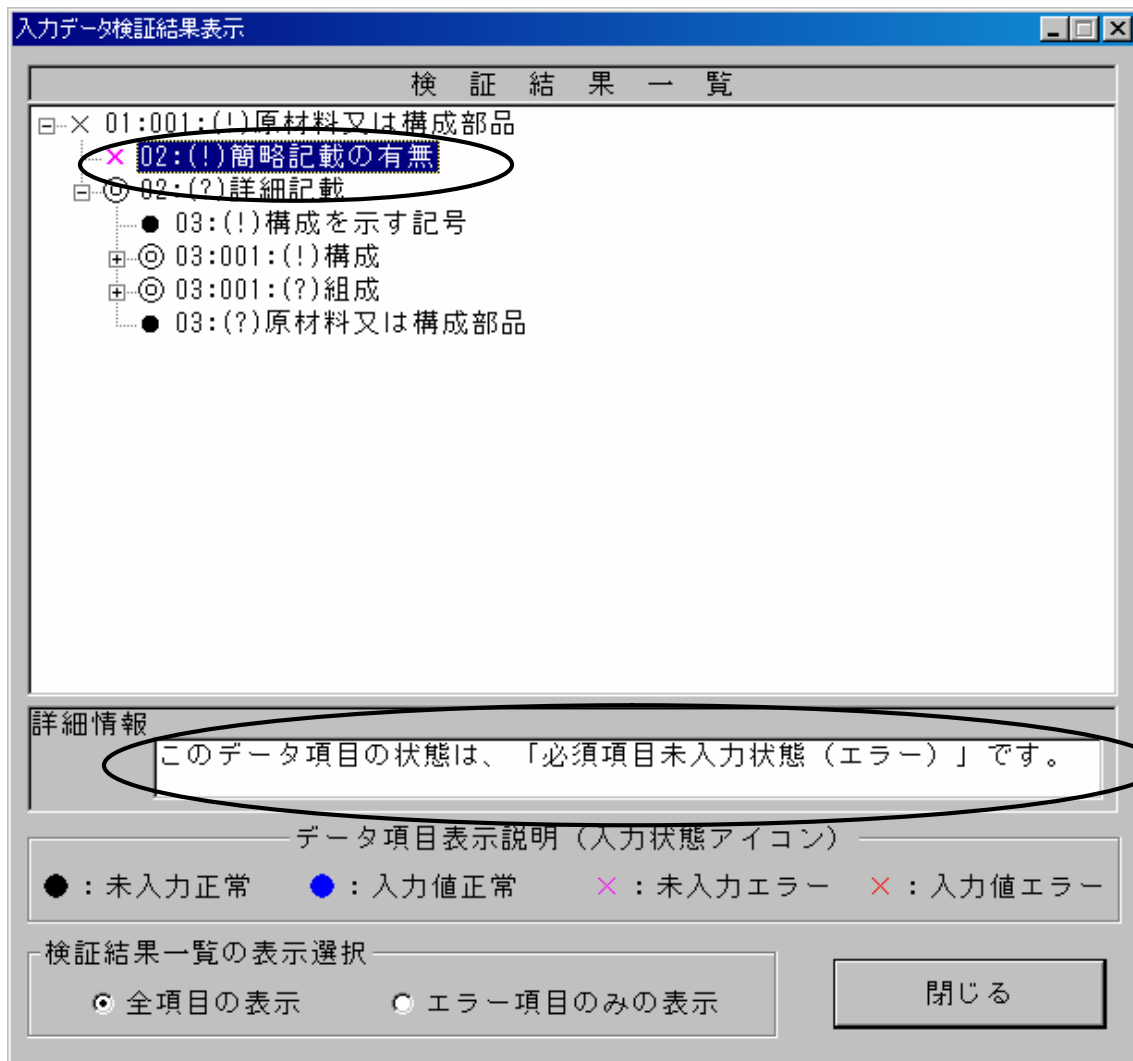

4. 例では「簡略記載の有無」が必須ですが未入力である為にエラーが出ています。
画面下段の「詳細情報」になぜエラーになっているのかが表示されます。